


## YY-miniDNA 核酸水平电泳槽

### 使用说明书

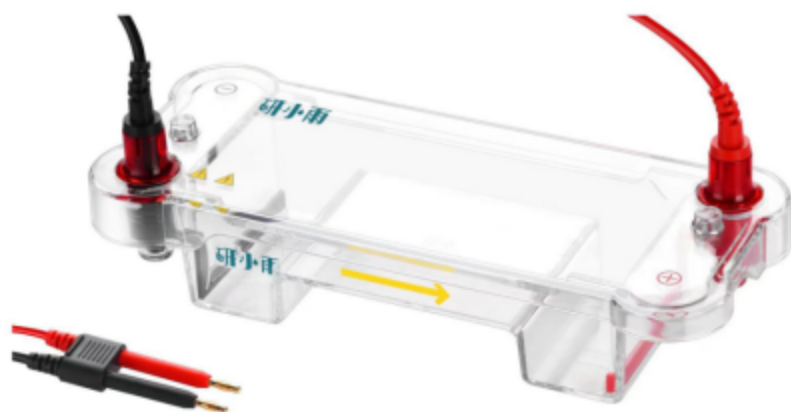

# 研小雨

## 目录

### 第一章 产品介绍

#### 1.1 简介

#### 1.2 结构组成

#### 1.3 主要技术参数

### 第二章 操作程序

### 第三章 维护保养

### 第四章 疑难排解

### 第五章 运输、贮存

### 第六章 质保

### 附表

### **重要安全操作信息！**

#### **使用前请认真仔细阅读！**

本手册包含重要操作和安全使用信息！为了更好的使用本仪器，使用前请认真仔细阅读和了解本手册内容！

仪器未使用时，为避免受到电击危险，请将仪器和电源断开。电源也应处于断电状态。使用前，请检查外槽体是否有裂缝，以免电泳时缓冲液从裂缝中漏出，产生漏电。另外，请检查导线和插头是否有连接松动、胶皮破损、导线腐蚀断开等现象，以免使用时对人体产生危害。仪器仅供本手册所说明的目的。在导线或者仪器损坏时，请不要继续使用本产品。移动本产品时请断开电源。电泳时，请注意槽体和实验台是否有缓冲液渗漏的情况。如有渗漏现象，请马上中断电泳并联系本公司或者当地办事处。

注意：本公司对不按照说明书使用而导致的后果不承担责任！

## 第一章 产品介绍

### 1.1 简介

YY-miniDNA 核酸水平电泳槽，主要用于少量 DNA 和 RNA 样品的琼脂糖凝胶快速分离电泳。专用灌胶台，使用方便。托盘带有耳型结构，便于操作。仪器主要包括凝胶托盘、下槽、上槽、制胶器和梳子等，制胶面积 7×10cm、7×7cm 两种。

### 1.2 结构组成

仪器购买后，使用前请对照装箱单检查配件是否齐全，以及查看仪器是否由于运输导致损坏。如配件有出入或者仪器有损坏，请马上联系公司或当地办事处。开箱时，用刀轻轻划开包装胶带，取出仪器即可。装箱单如下：

配件	数量	配件	数量
主槽	1 个	上盖及电源线	1 套
可换电极	1 对	制胶架	1 个
凝胶托盘	1 个	梳子	3 把
	7×10 cm, 1 个		9/16 齿, 0.75mm 厚
	7×7 cm, 1 个		9/16 齿, 1.0mm 厚
			9/16 齿, 1.5mm 厚
使用说明书	1 份	保修卡	1 份
合格证	1 个		

### 1.3 技术参数

尺寸	266×115×113mm
托盘面积 (W×L)	7×10cm、7×7cm
梳子	9/16 齿, 0.75mm 厚 9/16 齿, 1.0mm 厚 9/16 齿, 1.5mm 厚
可同时制胶数	1 块
最大缓冲液	300ml

重量(净重)	1Kg
--------	-----

仪器工作所需电源为直流电源。仪器所能承受的最大电源参数如下:

最大电压	150V
最大功率	10W
最高缓冲液温度	40℃

## 第二章 操作程序

1. 将制胶架放在一个水平的桌面上,然后将凝胶托盘放到制胶架里,之后再放梳子于狭槽里。

2. 根据被分离 DNA 片段的大小,用电泳缓冲液配制适宜浓度琼脂糖溶液:应准确称量琼脂糖干粉将其加入到盛有已定量缓冲液的三角烧瓶或玻璃瓶中,用玻璃棒搅拌均匀后放入沸水浴或微波炉中加热至琼脂糖融化。(琼脂糖凝胶浓度选择见附表)

3. 待凝胶稍微冷却后,缓慢倒入凝胶托盘中,胶厚度以 3~5mm 为宜(注意:胶内不能有气泡)。

4. 让凝胶溶液完全凝结,室温下 30~45min(待胶略凝结时,也可以放入 4℃冰箱,可大大缩短凝结时间)。小心拔出梳子,将凝胶安放到电泳槽内,加样孔一侧靠近阴极(黑色)。

5. 向电泳槽内加入电泳缓冲液,至少没过凝胶 2mm。(注意:TAE 缓冲液,一般用 2~3 次就要更换,TBE 缓冲液则可使用 10 次左右。)

6. 取适量的 DNA 样品与 10×加样缓冲液混合(分析单一 DNA 样品,如 L 噬菌体或质粒 DNA,每个 5mm 宽加样孔可加 100~500ng DNA。如果样品由不同大小的许多 DNA 片段组成,如哺乳动物 DNA 酶切样品,则每个加样孔加入 20~30μg 的 DNA 也不会造成分辨率明显下降),然后用移液枪将样品加入样品孔内。一定要包含合适的 DNA 分子量标准物,将其分别加至样品孔的左侧和右侧孔中。

7. 加样完毕后,盖上电泳槽上盖,连接电泳仪电源。给予 5~8V/cm 的电压,其中距离以阳极至阴极之间的测量为准。阳极和阴极由于电解作用将产生气泡。DNA 应向阳极(红色插头)侧泳动。电泳时间的选择取决于胶的长度、电压和 DNA 片段的大小。胶越长,电压越低, DNA 片段越大,所需时间就越长。然而使用高压时,大的 DNA 片段的分辨率很低,电泳出的条带不清晰。(每厘米凝胶电压不超过 8V,若电压过高分辨率会降低,只有在低电压时,线性 DNA 分子的电泳迁移率与所用电压成正比。)

8. 当指示剂迁移到凝胶底部时,关上电源并取出样品放入事先配好的 EB 溶液中染色 5~10min(EB 见光分解,应置于暗室中),在紫外透射仪上观察并可用数码相机进行拍摄(也可在制胶时将 EB 加入到凝胶中)。

## 第三章 维护保养

1. 产品使用环境:温度 0℃~40℃,相对湿度不超过 95%,无腐蚀性气体和通风良好的室内。

2. 仪器使用后,请将凝胶托盘、下槽、制胶器和梳子用柔和去污剂小心清洗干净,小心不要弄断电极上的铂金丝。

3. 电极头弄湿后, 请尽快用吸水纸擦干, 以防生锈。电极头使用时间长后, 生如果生锈接触或者不良, 将电极头拧下换上新的即可。

4. 电极上的铂金丝是易耗品, 长时间使用后会变细, 对电泳效果产生影响。将电极拧下换上新的即可。

5. 请不要让电泳仪接触酸溶液和碱溶液, 以防对仪器造成腐蚀, 损坏仪器。

## 第四章 疑难排解

故障现象	原因分析	排除方法	备注
DNA 带模糊	DNA 降解	实验过程避免核酸酶污染	
	电泳缓冲液陈旧	电泳缓冲液多次使用后, 离子强度降低, pH 值降低, 缓冲能力减弱, 从而影响电泳效果。要经常更换电泳缓冲液。	
	所用电泳条件不合适	电泳时电压不应该超过 8V/cm, 温度小于 40℃。巨大 DNA 链电泳, 温度应小于 15℃。核查所用电泳缓冲液是否有足够的缓冲能力。	
	DNA 上样量过多	减少 DNA 上样量。	
	DNA 样含盐过高	电泳前通过乙醇沉淀除去多余的盐。	
	有蛋白污染	电泳前酚抽提除去蛋白。	
	DNA 变性	电泳前勿加热, 用 20mM NaCl 缓冲液稀释 DNA。	
不规则 DNA 带迁移	对于 $\lambda$ /Hind III 片断的 cos 位点复性	电泳前于 65℃加热 5 分钟, 然后在冰上冷却 5 分钟。	
	电泳条件不合适	电泳时电压不应该超过 8V/cm, 温度小于 40℃。经常更换电泳缓冲液。	
	DNA 变性	用 20mM NaCl 缓冲液稀释 DNA。电泳前勿加热。	
带弱或者无 DNA 带	DNA 的上样量不够	增加 DNA 上样量。	
	DNA 降解	避免 DNA 核酸酶的污染。	
	DNA 走出凝胶	缩短电泳时间, 降低电压, 增强凝胶浓度。	
	对于 EB 所污染的 DNA, 所用光源不合适	应用短波长 (254nm) 的紫外光源。	

DNA 带缺失	小 DNA 带走出凝胶	缩短电泳时间,降低电压,增强凝胶浓度。	
	分子大小相近的 DNA 不易分辨	增加电泳时间,使用正确的凝胶浓度。	
	DNA 变性	电泳前请勿高温加热 DNA 链,用 20mM NaCl 缓冲液稀释 DNA。	
	DNA 链巨大,常规凝胶电泳不合适	在脉冲凝胶电泳上分析。	
样品泳道不直	凝胶没有完全凝固 梳子齿歪了 凝胶有气泡	凝胶凝固至少 30~40min。 检查梳子。 制胶时注意凝胶不能有气泡。	
高分子量条带清楚漂亮,但低分子量条带弥散	胶浓度低	使用合适浓度胶。 换用丙烯酰胺胶来分离。	
胶融化了	温度太高	选择合适电压。 缓冲液使用次数太多或者配置不对,重新配置。	
样品条带弥散	样品中的盐浓度高 温度太高 上样太多 样品降解 制胶时样品孔破了	减少样品盐浓度。 降低电压或者重新配置缓冲液。 增加胶厚度或者上样要合适。 重新提取样品。 重新制胶。	

## 第五章 运输、贮存

1. 运输、贮存时请勿重物压。搬动时,请轻拿轻放。
2. 包装后的产品应贮存在温度-20℃~55℃、相对湿度不超过 93%、无腐蚀性气体和通风良好的室内。

## 第六章 质保

- 1) 产品自售出之日起,整机免费保修一年。
- 2) 下列情况,不属于免费保修范围,但可实行收费维修,终身服务:
  - a. 梳子齿因长期高温烧烫,不排除颜色会变暗;
  - b. 铂金丝自然损耗或人为折断;
  - c. 电源线的两头因腐蚀气体蒸发而自然生锈,造成电路不通;

- d. 托盘因长期使用会有明显划痕；
- e. 意外因素及不按使用说明书操作；
- f. 超过有效期，经修理仍可继续使用的；
- g. 不能出示保修卡及发票或涂改发票。

附表：（以供参考）

琼脂糖凝胶浓度（质量体积比）	可分辨的线性 DNA 片段大小（kb）
0.4 %	5~60
0.7 %	0.8~10
1.0 %	0.4~6
1.5 %	0.2~4
1.75 %	0.2~3
2.0 %	0.1~3



单位：北京研雨科技有限公司  
地址：北京经济技术开发区（通州）科创东五街2号15幢2层B区  
邮编：100176  
电话：4006688905  
电子邮件：order@yanyu-tech.com